

Stieber Bt.
1181 Bp., Nyerges u. 6.
Tel: 297-3130, 295-3642
Munkaszám: M 616/2014

Kalibrálólaboratórium

Bizonyítvány száma: N 175/2014

KALIBRÁLÁSI BIZONYÍTVÁNY

Megnevezés: CO riasztó
Típusa: XC100D
Gyári száma: 14051661129202
A megrendelő neve és címe: Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
1139 Budapest, Petneházy u. 2-4.

A kalibráláshoz alkalmazott használati etalonok gyári száma, hitelesítési bizonyítványának száma és kelte:

DC2403, GKL.Kbiz-238/2013, 2013.11.06; MGH1794, GKL.Kbiz-191/2012, 2012.11.12;
D883471, GKL.Kbiz-183/2013, 2013.08.12; Gázkeverő, Signal Model 821, gyári szám: 12940,
OMSZ 01/2014

Mérési módszer: összehasonlítás hiteles gáz etalonnal

A környezeti hőmérséklet: 23 °C
A légköri nyomás: 1001 hPa

A mérési eredmények:

Vizsgálati pontok	Riasztási idők	Minősítés
33 ± 3 ppm	2 órán belül nem riaszthat	Megfelelt
55 ± 5 ppm	60-90 perc között riaszt	Megfelelt
110 ± 10 ppm	10-40 perc között riaszt	Megfelelt
330 ± 30 ppm	3 percen belül riaszt	Megfelelt


Megjegyzés: A megrendelő kérésére az MSZ EN 50291-1:2014 szabvány által előírt riasztási követelményeket vettük alapul.

A kalibrálás helye: 1181 Budapest, Nyerges u. 6.
A kalibrálás időpontja: 2014.08.21.
A bizonyítvány kiadásának dátuma: 2014.08.22.

A bizonyítvány oldalainak száma: 1

A bizonyítvány kiadható!

A kalibrálást végezte: Meizner Zsolt

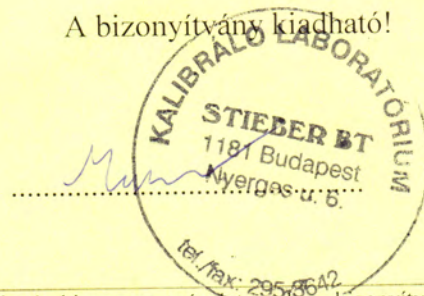

A jelen bizonyítvány csak teljes formájában érvényes és másolható, kivonatos másolat csak a bizonyítványt kibocsátó szervezet hozzájárulásával készíthető.